


Bestückungsbild der A-Seite

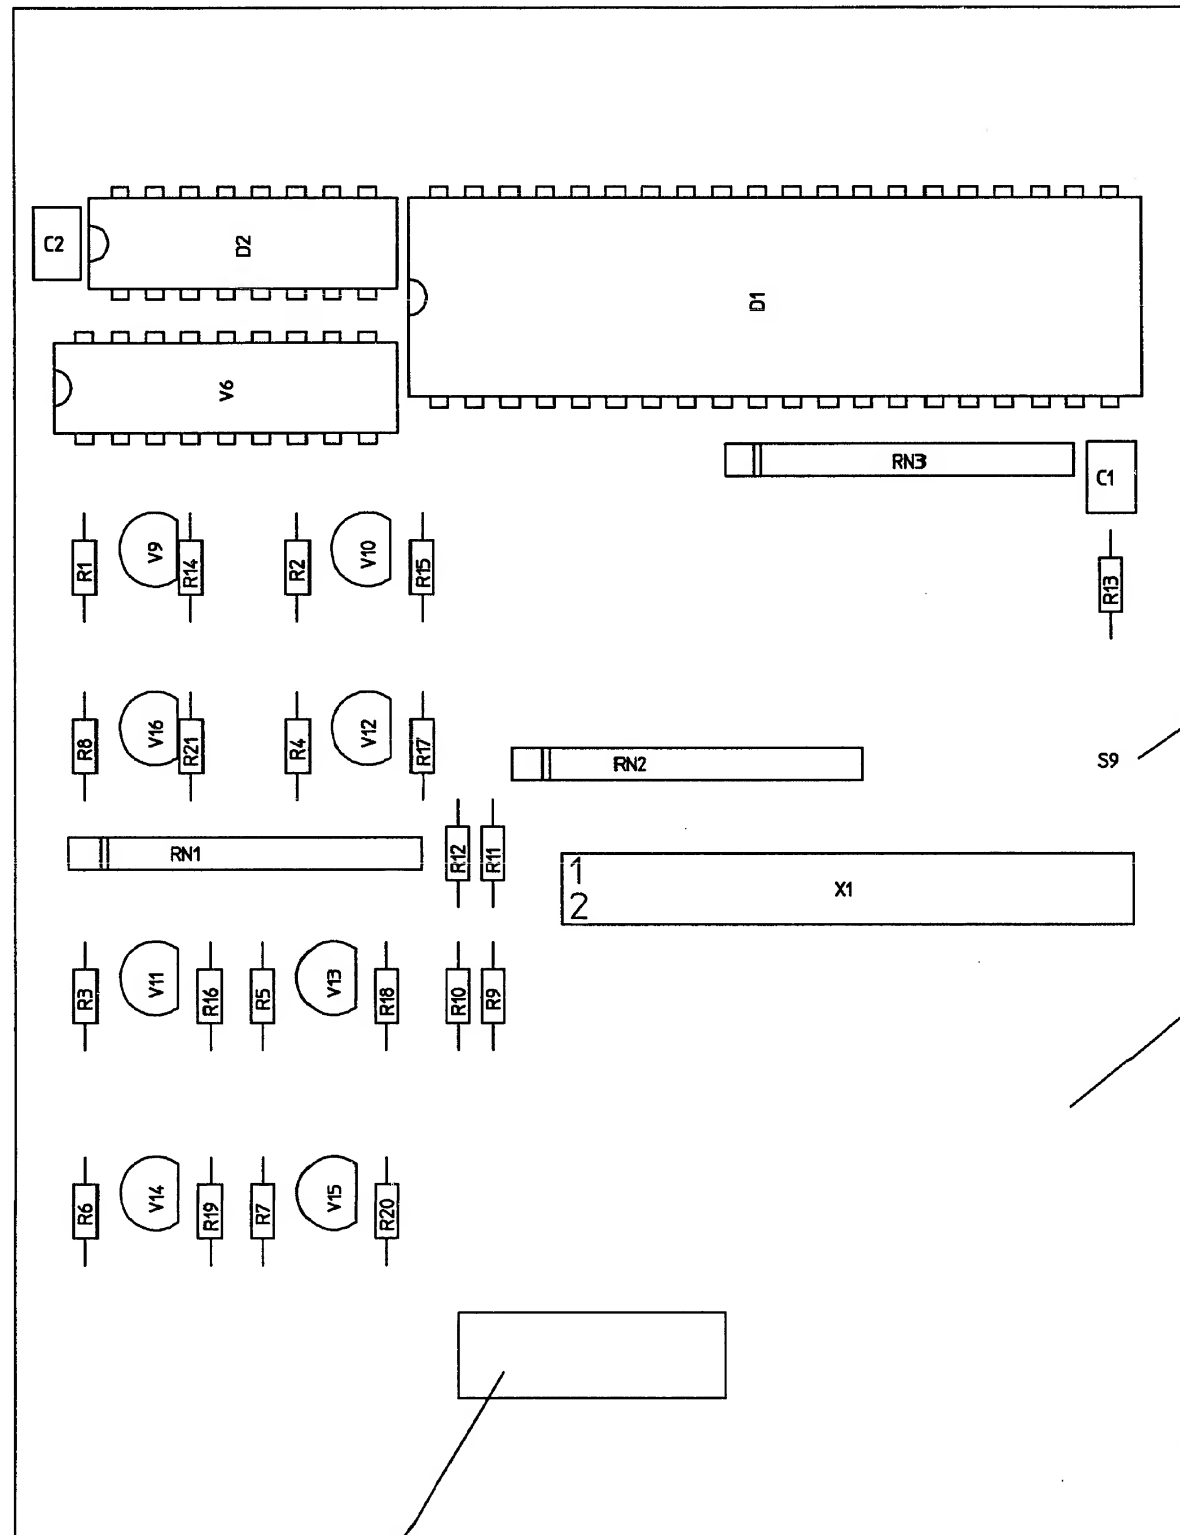

S9 geschlossen

8290432

8303296

gekennzeichnet mit 2 mm Schrifthöhe :

8290451 4.0

Fabrik-Nr. nach DWN 419-A


- Prüfung nach FKV durchgeführt
- Schutzlackierung nicht durchgeführt
- Ausführung nach DWN 3007

hierzu : SPlan 8290454
FKV K02533
Stückliste ST8290451


| | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| -QA- | - | -QB- | - | -QC- | - |
| Werkstoff | | | | 4 | - |
| - | | | | Sockel entfernt. (002/98) | |
| Maßstab | Allgemein-toleranzen | Abteilung | 1998 | Tag | Name |
| 2:1 | - | MT | Bearb. 08.01. | Huß | Dräger |
| | | | Gepr. 1.1. | Kleinert | Dräger Medizintechnik GmbH |
| Benennung | | | Zeichnungs-Nr. | | Blatt 1 von 4 Bl. |
| Best. LP Display-Feuchte (Inkubator 8002) | | | 8290451 | | |
| HPDC-6 | | | Ersatz für 8290451*03 | | Ersetzt durch |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved
DRÄGER AG, Lübeck


Bestückungsbild der B-Seite

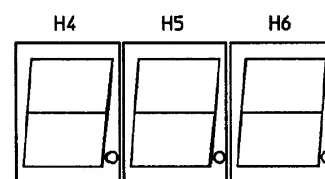



Einbaumaß für V21

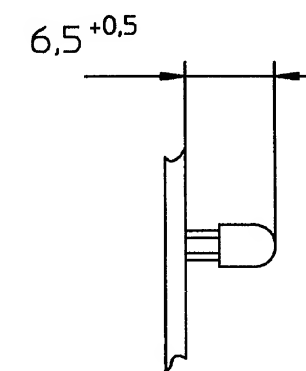

Einbaumaß für :
H4, H5, H6

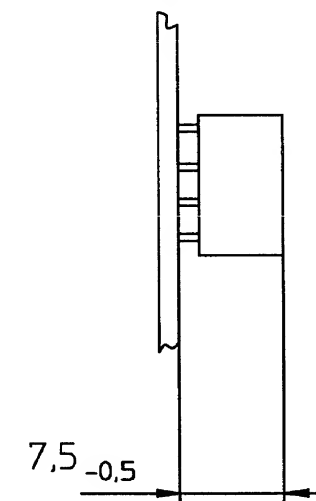


| | | | | | |
|-----------|---|---|-----------|---|---|
| -QA- | - | -QB- | - | -QC- | - |
| Werkstoff | | 4 | - | siehe Blatt 1 | |
| Maßstab | | Allgemein- toleranzen | Abteilung | Änderungen | |
| 2:1 | | - | MT | Dräger Medizintechnik GmbH | |
| Benennung | | Best. LP Display-Feuchte (Inkubator 8002) | | Zeichnungs-Nr. 8290451 Blatt 2 von 4 Bl. | |
| HPDC-6 | | Ersatz für 8290451*03* | | Ersetzt durch | |

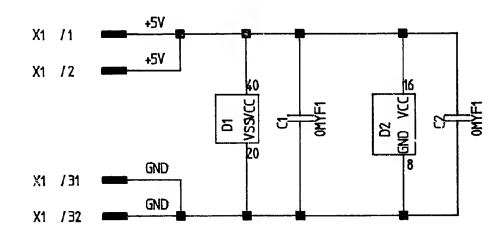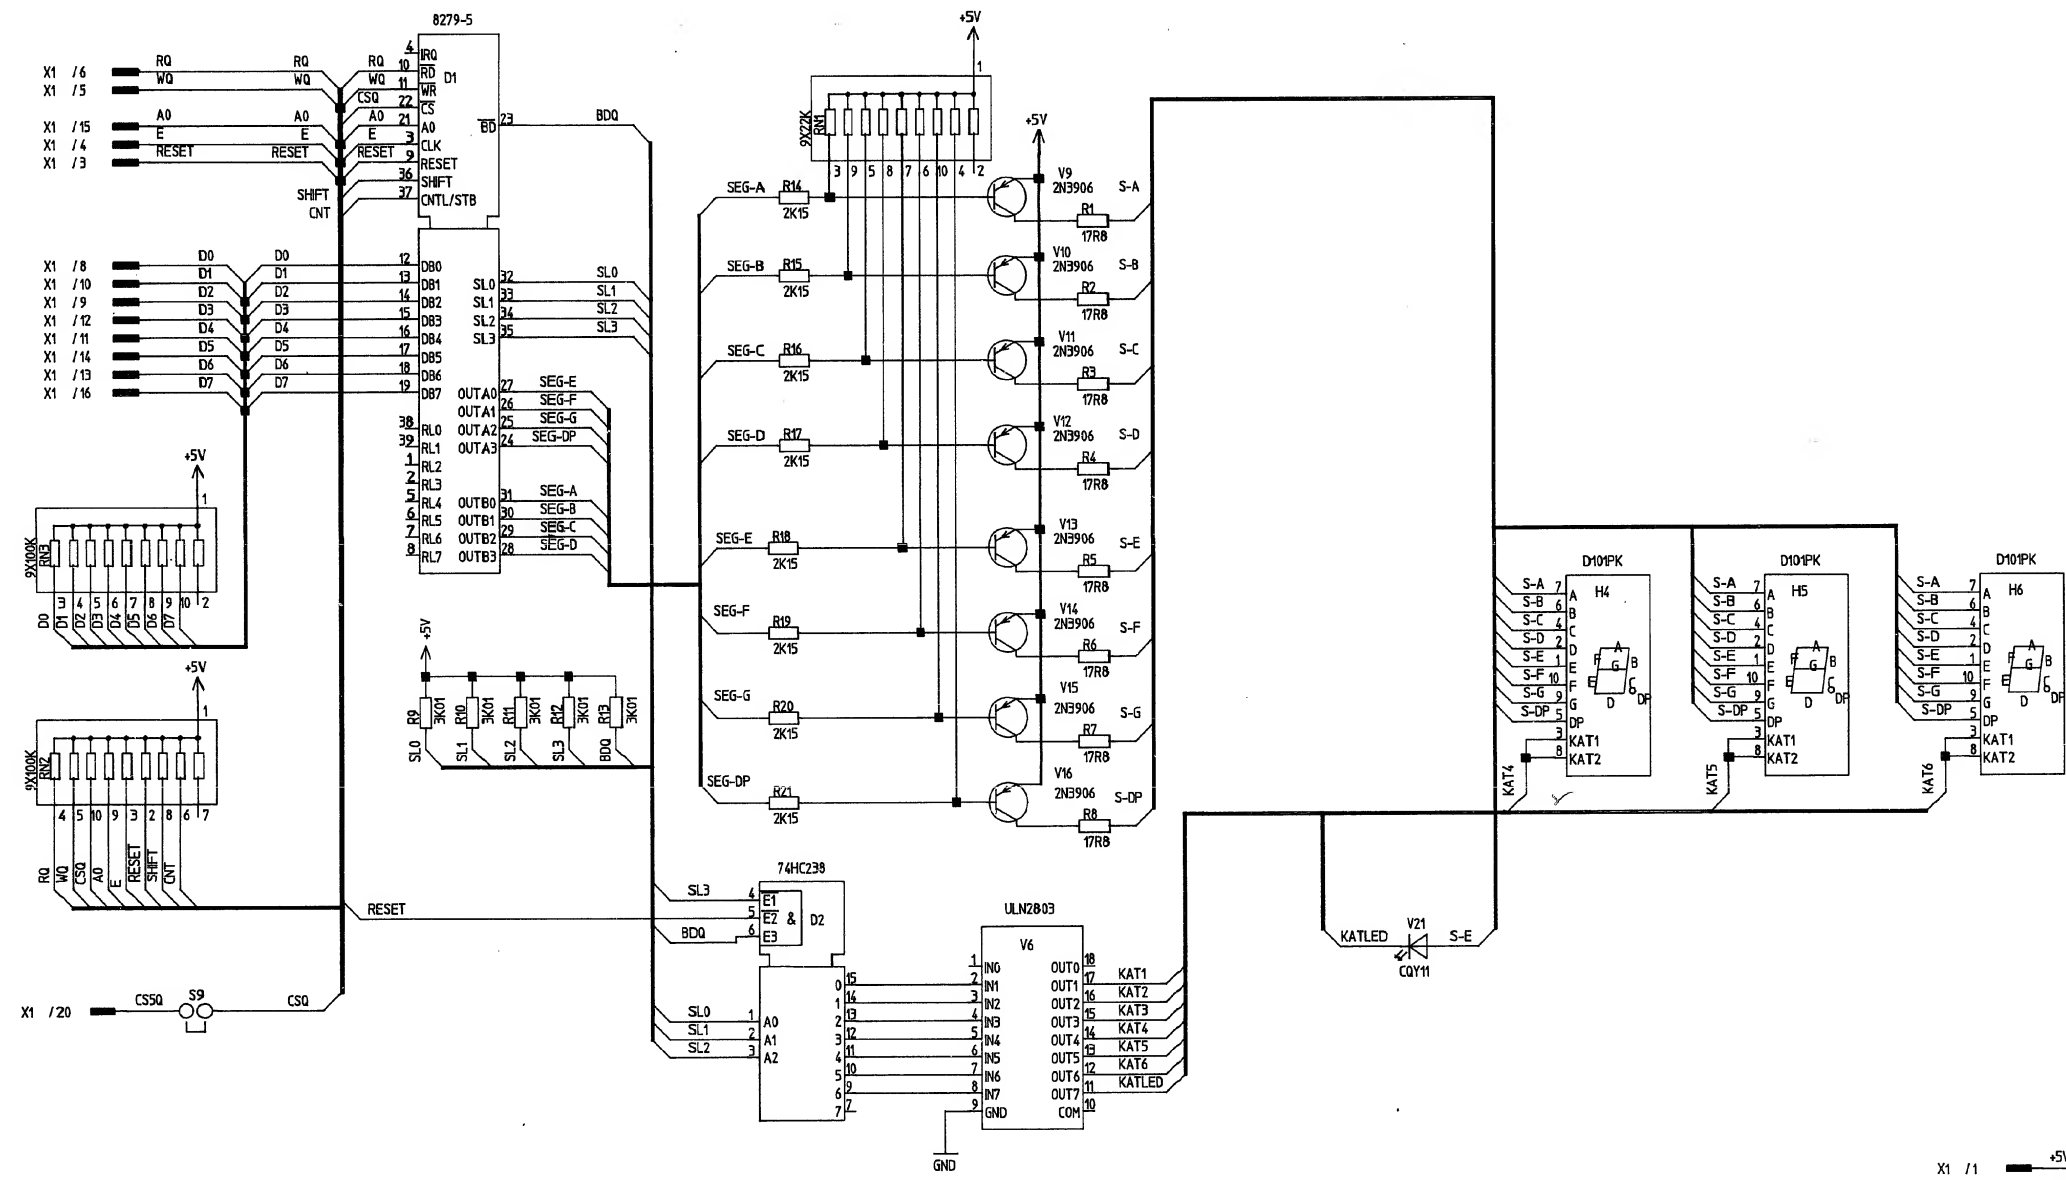

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|---|--|-------|----------------------------------|----------------------|
| -0A- | - | -0B- | - | -0C- | - | | |
| Werkstoff | | | | | | | |
| - | | | | 3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Schalter durch Loetschalter ersetzt (189/93) | | | |
| | | | | Änderungen | | | |
| Maßstab | Allgemein- toleranzen | Abteilung | 1993 | Tag | Name | Drägerwerk Aktiengesellschaft | Dräger |
| - | - | MT | Beart. | 17.12 | Faber | | |
| | | | Gepr. | 11.11 | Klei | | |
| | | | Norm | --- | --- | | |
| Benennung | | | SPLAN LP Display-Feuchte (Inkubator 8002) | | | Zeichnungs-Nr. 8290454 | Blatt 1 von 1 Bl. |
| HPDC-6 | | | | | | Ersatz für 8290454 *00* | |
| | | | | | | Ersetzt durch | |

Schulungszentrum für die Produktion
Use of this document is forbidden
without the express written permission
of the Drägerwerk Aktiengesellschaft


Bestückungsbild der A-Seite

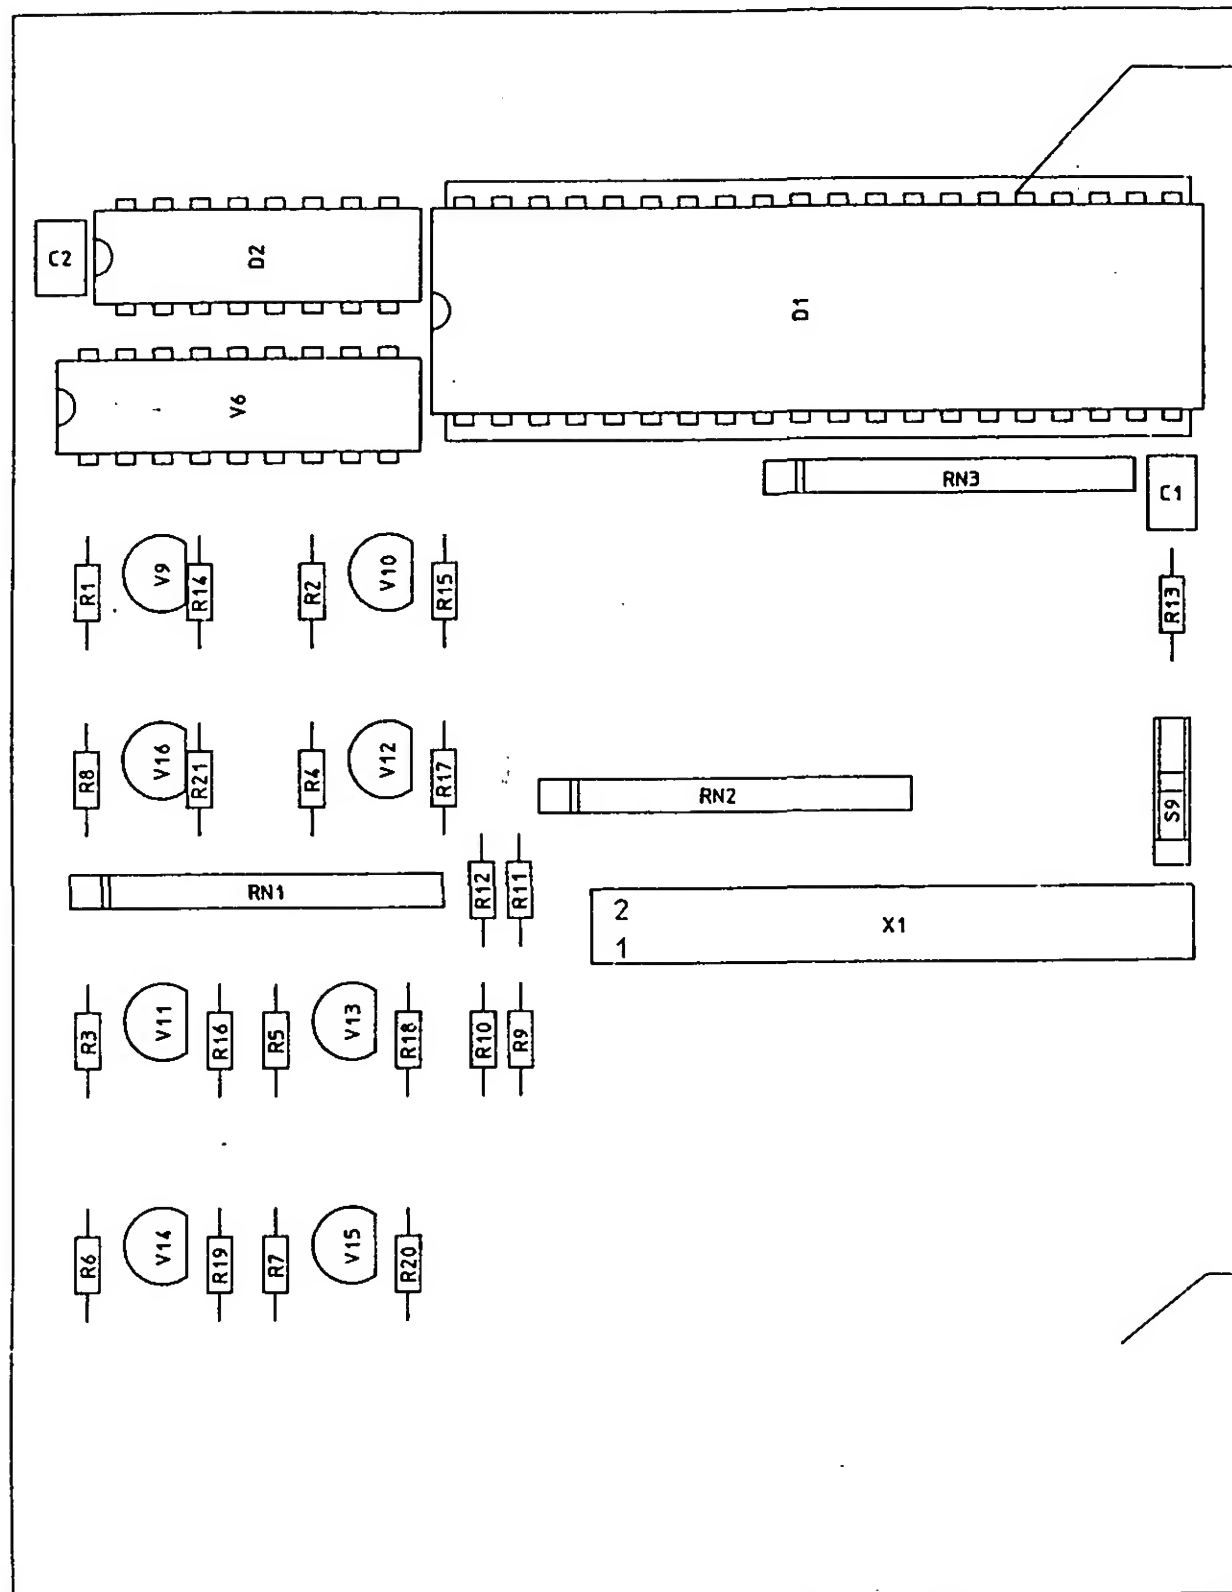

Diese Zeichnungspause dient
nur zur Lesehilfe. Bei Ände-
rung erfolgt kein Austausch.


| | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| -0A- | --- | -0B- | --- | -0C- | --- |
| Werkstoff | | | | 0 | - |
| | | | | (22/89) | |
| | | | | Änd. Ziffer | kommt vor |
| Maßstab | Allgemein- toleranzen | Abteilung | 1989 | Tag | Name |
| 2:1 | --- | RM | Beard | 07.12. | Alb |
| | | | Gepr | 15.11. | Ku |
| | | | Norm | 18.12.1989 | ja |
| Benennung | | | LP | | |
| | | | Display-Feuchte, Ugr. | | |
| | | | (Inkubator 8002) | | |
| Zeichnungs-Nr. | | | BLATT 1 | | |
| 8290453 | | | VON 4 BL. | | |
| Ersatz für | | | | | |
| Ersetzt durch | | | | | |

Bestückungsbild der B-Seite

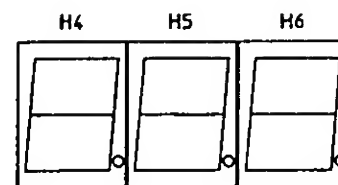


○ V21

EINBAUMASZ FUER V21 :

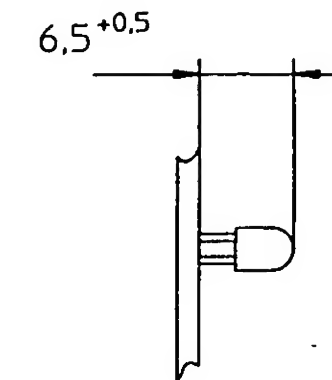


EINBAUMASZ FUER : H4, H5, H6

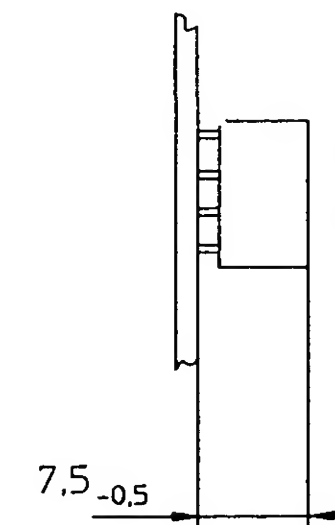


Diese Zeichnungspause dient
nur zur Information. Bei Ände-
rung ist die Zeichnung in Ausfertigung
zu ersetzen.

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------|
| -0A- | -- | -0B- | -- | -0C- | -- |
| Werkstoff | | | | 0 | - |
| ----- | | | | siehe Blatt 1 | |
| Maßstab | Allgemein- toleranzen | Abteilung | 1989 | Tag | Name |
| 2:1 | --- | RM | 07.12 | Alb | |
| | | | Gepr | 18.12 | 1989 ja |
| | | | Norm | 18.12 | 1989 ja |
| Benennung | | | LP | | |
| | | | Display-Feuchte, Ugr. | | |
| | | | (Inkubator 8002) | | |
| Zeichnungs-Nr. | | | BLATT 2 | | |
| 8290453 | | | VON 4 BL. | | |
| Ersatz für | | | | | |
| Ersetzt durch | | | | | |

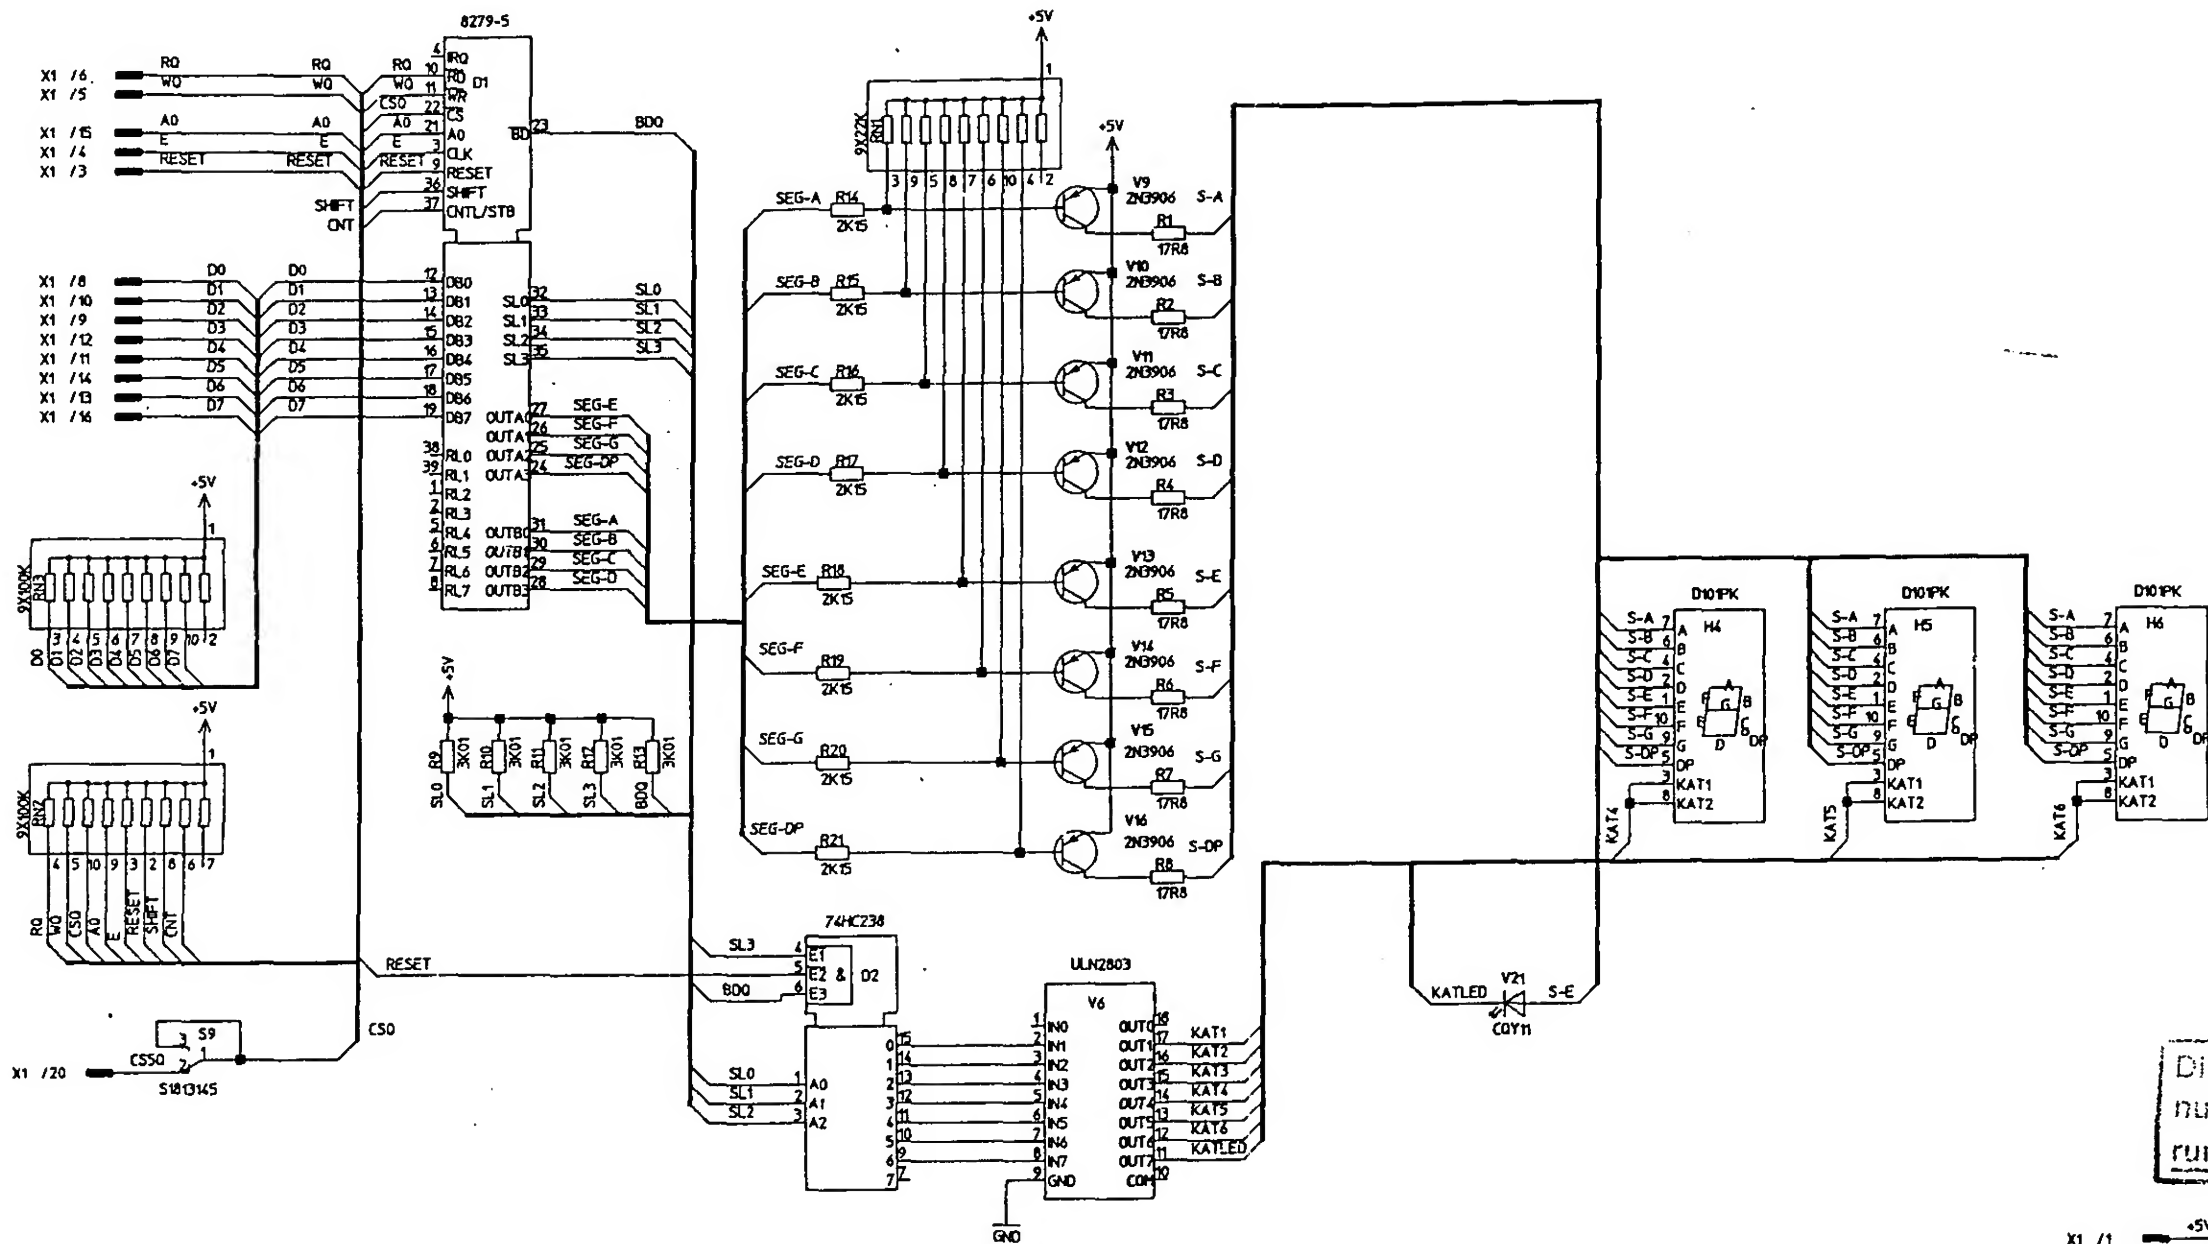

Diese Zeichnungspause dient
nur zur Information. Bei Änderung
erfolgt kein Austausch

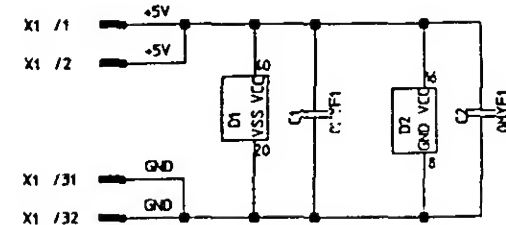

| | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| -0A- | -0B- | -0C- |
| Werkstoff | | |
| 0 - | | |
| (22/89) | | |
| Maßstab | Allgemein- toleranzen | Ableitung |
| --- | --- | RM |
| Benennung | | Tag |
| S-Plan | | 07.12 |
| LP Display-Feuchte | | Gepr. / 1.1.11 |
| (Inkubator 8002) | | Norm 1.8.17 1989 ja |
| Zeichnungs-Nr. | | Blatt |
| 8290454 | | 1 |
| Ersatz für | | VON 1 BL. |
| Ersetzt durch | | |

A3-104